
INFORMAÇÕES PARA AGENDAMENTO


Para agendamento acesse o site dos laboratórios multiusuários https://www.uricer.edu.br/site/informacao?pagina=principal&id_sec=125&cod=701

Escolha o laboratório multiusuário de interesse e você será direcionado para a página da Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa MCTI.

Realize o acesso:

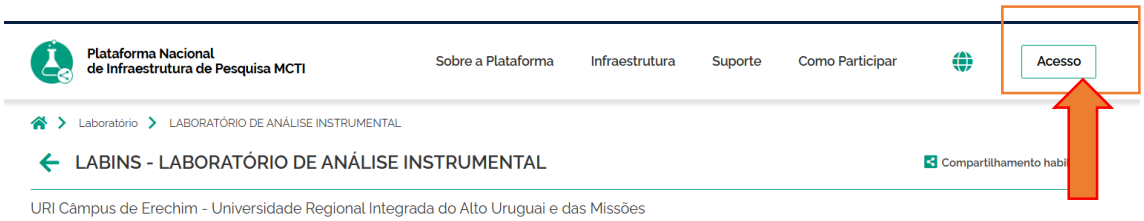

Faça o login, se não tiver cadastro entre em crie a sua conta

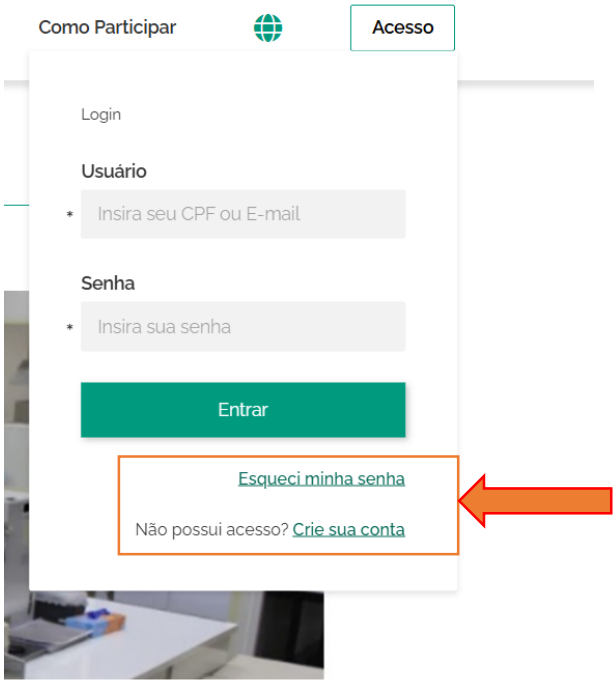

Data de criação: 30/08/2022

Retorne a página para escolher o laboratório e na sequencia escolha o equipamento

LABINS - LABORATÓRIO DE ANÁLISE INSTRUMENTAL

Compartilhamento habilitado

URI Câmpus de Erechim - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões



Sobre este laboratório

Data de criação: 30/08/2022

O Laboratório de Análise Instrumental (LABINS) presta serviços à comunidade acadêmica da URI e outras Instituições e a empresas de diferentes segmentos. Entre os equipamentos que constituem sua infraestrutura laboratorial, destacam-se o Cromatógrafo Gasoso (GC-FID) o Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (HPLC) e o analisador de Carbono Orgânico Total (COT), Difratograma de Raio X, analisador de área (BET), de atividade de água (Aw), umidade, por infravermelho, colorimetro.

Endereço

Avenida Sete de Setembro
Erechim - RS - 1621
CEP 99709-910
Veja como chegar

Contato

Responsável: Claudio Zakrzevski
Telefone: (54) 3520-9000
Email:
Website:

Área de atuação

Controle de qualidade | Desenvolvimento de Produtos | Avaliação de matérias-primas e produtos finais | Estudo de caso

Principais Técnicas

Análises qualitativas, semi-quantitativas e quantitativas de compostos vo.. | Análises de compostos não voláteis ou instáveis termicamente | Análises de quantificação de carbono orgânico total, carbono inorgânico ..

Equipamentos


	Código	Nome	Marca	Modelo	
●	Cod9D5D6E/23	Analisador de atividade de água	IABTOUCH	Basic	
●	CodW5KY26/22	Analisador de carbono orgânico total de líquidos	Shimadzu	TOC VCSH	
●	CodA4E3B2/23	Colorímetro CR400	CHROMA METER	CR-400	
●	Cod30BF9P/22	Difratômetro de raio X	Rigaku	MiniFlex II	
●	Cod718RAB/22	Medidor de area superficial	Quantachrome	Nova 2200e	
●	CodC1GS97/23	Medidor de umidade com fonte de calor infravermelho	MARCONI	ID-200	
●	CodH6PC30/22	Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência	Agilent	1100 Series	

Solicitar utilização

Você pode entrar em contato com este laboratório enviando uma solicitação de utilização por meio do botão abaixo. É necessário estar logado para submeter o formulário

Solicitar utilização

Ao acessar a página preencha as informações para agendamento e em seguida clique no botão enviar.

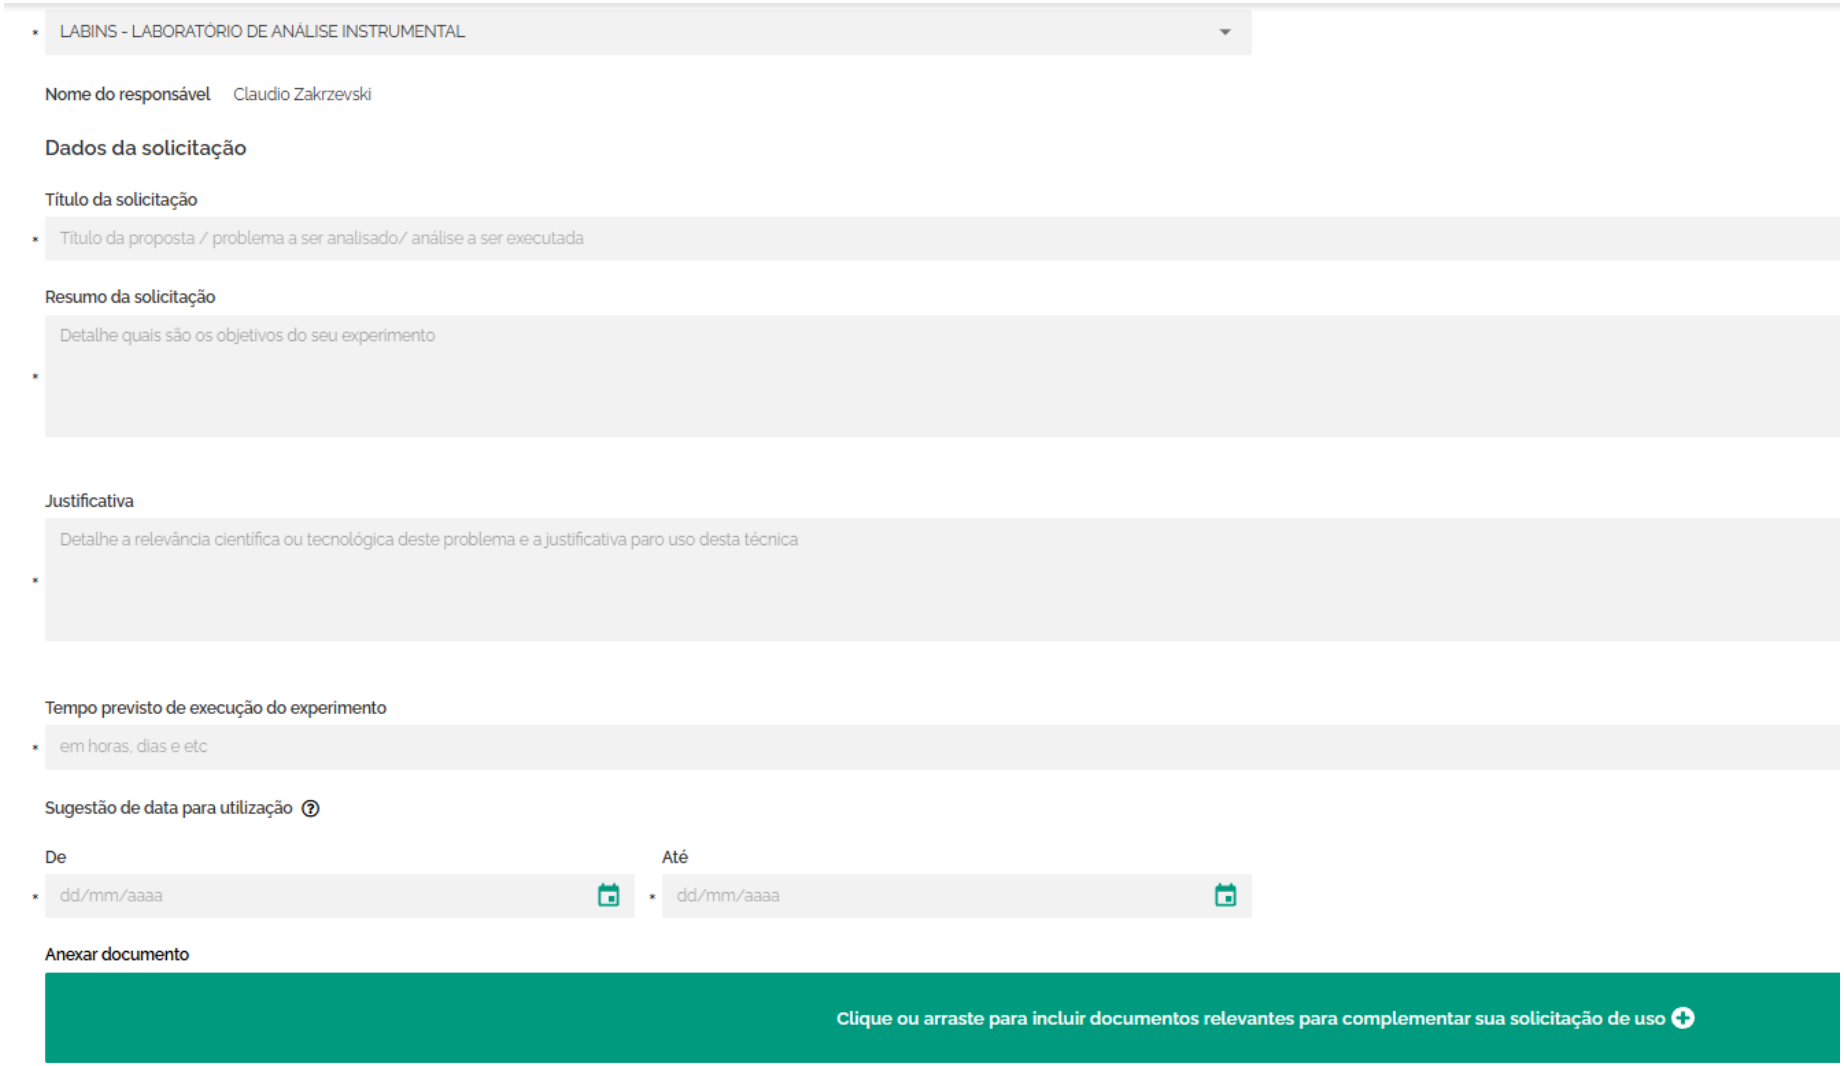

Amostra

• A sua solicitação implica em levar uma amostra ao laboratório? ○ Sim ○ Não ○ Não se aplica

Dados do solicitante

CPF
• 004.271.590-32

Nome
• CLARICE

Sobrenome
• STEFFENS

E-mail
• claristeffens@yahoo.com.br

Telefone
• Insira...

Link do currículo Lattes
Insira a URL

Vinculo principal do solicitante

Nome da instituição
• Insira...

CNPJ da instituição
• 99.999.999/9999-99

Tipo de instituição
• Selecione...

• ☐ Declaro que estou ciente que a minha solicitação pode acarretar em custos determinados pelo laboratório e que a plataforma não é responsável por essa operação

Cancelar | Enviar

